



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65
CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

**PESQUISA DE PREÇOS Nº 3/2021.
PARA COMPRA DIRETA**

A CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS, HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC, informa que está promovendo **pesquisa de compra direta**.

Essa pesquisa NÃO é destinada a formar preço para futura licitação, é para comprar do fornecedor que apresentar menores valores para o contido no anexo I.

Os recursos para a aquisição do objeto da presente pesquisa de preços são provenientes do **Contrato nº 107/2020 – SES 70386/2020** – Secretaria de Estado da Saúde destinados ao combate da pandemia da COVID-19.

CONDIÇÕES GERAIS

- 1) Os interessados deverão enviar suas propostas, nas condições e prazos aqui mencionados, não serão aceitas propostas que não cumpram ou que se desviem das condições aqui estipuladas **sob pena de desclassificação**;
- 2) O preço unitário e total deverá ser fixo em reais, com até 03 (três) casas decimais. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que os compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente o fornecimento dos produtos, sem quaisquer ônus para o Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal;

ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 3) A propostas será recebida por e-mail ou por meio físico (envelope), assim sendo, os interessados deverão enviar **01 (um) email** ou então, **01 (um) envelope** contendo a proposta identificado como: **PESQUISA DE PREÇOS 3/2021**.
- 4) Os interessados deverão apresentar suas propostas conforme item 03, seguindo o modelo do anexo I, até o **dia 14 de janeiro de 2021, até as 9 horas**, para o endereço eletrônico **licitacoes@hnsdd.com.br** ou de forma física, no mesmo prazo entregar para o Hospital Nossa Senhora das Dores, no endereço: Rua Dr. Wilson Bordin nº 48, Bairro Centro, Capinzal - SC, CEP nº 89.665-000. Sendo que a abertura e análise será **efetuada no mesmo dia às 10 horas**, pela comissão de licitações, e será publicado o quadro comparativo de preços no sítio do Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal: www.hnsdd.com.br.
- 5) Os vencedores ficam obrigados a entregar juntamente com a nota fiscal, documentos de regularidade fiscal conforme exige a lei 8.666/93.
Retirada do edital: www.hnsdd.com.br
Informações: licitacoes@hnsdd.com.br

Capinzal, 7 de janeiro de 2021.


ADELAIDE FRIGO
Diretora



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-85 Inscrição Estadual: Isento
 Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

ANEXO I

**PESQUISA DE PREÇOS Nº 3/2021.
 PARA COMPRA DIRETA**

I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE

Razão Social:

Endereço:

Bairro:

Fone/Fax:

E-mail:

CNPJ:

Banco:

Município:

CEP:

Home Page:

Inscrição Estadual:

Agência Nº

Conta Corrente:

Responsável pela assinatura do contrato:

Cargo:

CPF:

RG:

II - APRESENTAÇÃO DE PREÇOS PELO VALOR GLOBAL

Os produtos cotados são para uso na prevenção do COVID-19.

A empresa deve COTAR A MARCA DOS PRODUTOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUINEOS</p> <p>Descritivo: Analisador de Sangue portátil (Point of Care) para determinação quantitativa simultânea de elementos sanguíneos específicos, para pacientes críticos ou não críticos, totalmente automatizado que dispõe de um vasto menu de testes indicadores de diagnóstico e tratamento relacionados com a gestão do estado da doença e as linhas de orientação clínica, utilizando apenas 100ul de amostra de sangue arterial ou venoso, o sistema fornece o resultado em questão de minutos, operado em punho, pesando aproximadamente 650gramas, medindo 7,68cm X 23,48cm X 7,24cm., com controle térmico, bateria interna de lítio e calibração eletrônica. Possuir sistema de introdução de dados tipo scanner e teclado alfa-numérico, e memoriza automaticamente até 1000 registros de testes. Sua saída e transmissão de dados são feita através de infravermelho e suas funções podem ser controladas por software de gerenciamento. Utiliza como único e exclusivo</p>	UN	1		



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

<p>reagente os cartuchos para para Bioquímica/Eletrólitos/Lactato, Hematologia, Gasometria, Coagulação, Endocrinologia e Marcadores Cardíacos, sem necessidade de eletrodos seletivos ou troca de gás. A leitura dos resultados ocorre em até 2 minutos para Bioquímica, Eletrólitos, Lactato, Hematologia e Gasometria, 5 minutos para Coagulação e 10 minutos para Endocrinologia e Marcadores Cardíacos. Acompanha impressora portátil para emissão de laudos, simulador eletrônico para calibração, base downloader/Recharger e bateria recarregável.</p> <p>Inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impressora portátil com infravermelho com pilhas recarregáveis e bobina de rolo termossensível, compatível com I-STAT. • Downloader/Recharger para recarregar uma bateria recarregável no analisador. Se o analisador contiver uma bateria recarregável, a bateria começa a recarregar automaticamente logo que o analisador é colocado no Downloader/Recharger. <p>O Downloader/Recharger tem também um compartimento para recarregar uma bateria recarregável fora do analisador. • Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel.</p> <p>CARTUCHOS: CARTUCHO CG4 Cartucho para exame de gasometria com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar os seguintes exames em amostras de sangue total venoso/arterial: Lactato, pH, PCO₂, PO₂, TCO₂, HCO₃, BE e SO₂. Leitura e resultado em 2 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível</p> <p>CARTUCHO cTnl Cartucho para dosagem quantitativa da Enzima Cardíaca Troponina-I (cTnl) com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar o teste de troponina cardíaca I em amostras de sangue total ou plasma, que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Leitura e resultado em 10 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível.</p> <p>A proponente deverá efetuar o treinamento do pessoal que irá trabalhar com o aparelho. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>MARCA: TODAS AS DIMENSÕES E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS.</p>				
TOTAL GLOBAL				



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: isento
Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

3 - CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

3.1. A Proposta apresentada tem validade de 15 dias, contados a partir da data de abertura da Proposta de Preços.

3.2. Prazo de entrega dos materiais: até 30 dias após o recebimento da Ordem de Compra que será via e-mail.

3.3. PAGAMENTO A VISTA após recebimento, conferência e atestado de conformidade.
(Prazo máximo de 5 (cinco) dias)

4. DECLARAÇÕES:

4.1 – Declaramos que no valor proposto já estão incluídos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, fretes, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e demais inerentes ao fornecimento dos produtos.

4.2 – Declaramos o objeto social da empresa é compatível com o fornecimento dos produtos cotados, e que os produtos cotados estão em conformidade com a descrição, e apresentam a garantia e validade nos termos da legislação.

4.3 - Declaramos que os preços aqui propostos são plenamente exequíveis e nos colocamos à disposição da Comissão de Licitações para informações complementares caso seja necessário.

4.5 - Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumprimos plenamente a legislação citada.

4.6 – Declaramos para fins de participação, e, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à participação na presente Pesquisa de Preços, e, que a empresa não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a administração. Também declara que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

4.7 – Declaramos sob as penas da Lei, que os produtos oferecidos nesta proposta de preços, são novos, ou seja, não foram utilizados e condizem com as especificações exigidas na descrição e estão devidamente registrados nos órgãos competentes, e caso seja necessário apresentaremos laudos e registros de sua validade.

(Município), em ____ de _____ de 2020.

NOME DA EMPRESA PROPONENTE

CNPJ:

Nome do(a) administrador(a)

CPF:

E-mail:



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65
CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
Tel: (49) 3555-1111 E-mail: convenios@hnsdd.com.br


DECLARAÇÃO DE PÚBLICAÇÃO
PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021.
PARA COMPRA DIRETA

Declaro para os devidos fins e efeitos que a íntegra do edital da pesquisa de mercado em epígrafe foi publicada no sítio do Hospital Nossa Senhora das Dores, endereço: www.hnsdd.com.br na data de 07/01/2021.

Capinzal, 07 janeiro de 2020.


ADELAIDE FRIGO
Diretora

Hospital N. S. das Dores
Cong. das Servas de M^ª. Reparadoras
Adelaide Frigo
Diretora/Administradora
CPF 808.868.097-20



Assunto: **PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.**
De: <licitacoes@hnsdd.com.br>
Para: Paulo Sergio Tillmann <paulo.tillmann4@gmail.com>
Data: 2021-01-08 09:37

• Pesquisa de preços 3-2021.pdf (~210 KB)


Bom dia,

Segue PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.

005. Favor enviar proposta conforme anexo I.

At

Juliete



Assunto: **Pesquisa de Preços nº 02/2021 e 03/2021 para compra direta.**
De: <licitacoes@hnsdd.com.br>
Para: <celcyendas@prov.da.medical.com.br>
Data: 2021-01-07 13:16

- Pesquisa de preços 2-2021.doc (~72 KB)
- Pesquisa de preços 3-2021.pdf (~210 KB)


Boa tarde,

Segue as Pesquisas de Preços nº 02/2021 e 03/2021 para compra direta.

Obs: Favor colar conforme anexo 1.

Att

Talita



Assunto: **PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA**
De: <licitacoes@hnsdd.com.br>
Para: <kev/n@c4solucoes.com.br>
Data: 2021-01-07 11:47

- Pesquisa de preços 3-2021.pdf (~210 KB)


Bom dia,

Segue PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.

095. Favor enviar proposta conforme anexo 1.

Att

Julietta



Assunto: **PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.**
De: <cliofetes@hnsdd.com.br>
Para: <medicare@medicarens.com.br>, <francisco@hnsclife.com.br>
Data: 2021-01-07 11:48

* Pesquisa de preços 3-2021.pdf (~210 KB)


Bom dia,

Segue PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.

Obs: Favor enviar proposta conforme anexo I.

Att

Juliete



Assunto: **PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.**
De: <licitacoes@hnsdd.com.br>
Para: <comercial@bemks.com.br>
Data: 2021-01-07 11:54

- Pesquisa de preços 3-2021.pdf (~210 KB)


Bom dia,

Segue PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.

Obs. Favor enviar proposta conforme anexo 1.

Atc.

Tullita



Assunto: **PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.**
De: <claraos@hnsdd.com.br>
Para: <contato@handlife.com.br>
Data: 2021-01-07 11:57

• Pesquisa de preços 3-2021.pdf (~210 KB)


Boa dia,

Segue PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.

OBS. Favor enviar proposta conforme anexo I.

Att

Juliana



Assunto: **PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.**
De: <licitacoes@hnsdd.com.br>
Para: <tatiane@suldiagnostica.com.br>
Data: 2021-01-07 12:02

- Pesquisa de preços 3-2021.pdf (~210 KB)


Boa dia,

Segue PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.

OBS. Favor enviar proposta conforme anexo I.

Atte

Tatiane



Assunto: **PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.**
De: elicio@cpes@hnsdd.com.br
Para: ceverton@ilhater.com.br
Data: 2021-01-07 12:10

- Pesquisa de preços 3-2021.pdf (~210 KB)


Bom dia,

Sobre PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.

OBS. Favor enviar proposta conforme anexo 1.

Att

Julietta



Assunto: PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.
De: <licitacoes@hnsdd.com.br>
Para: SAC - PO,NTMED <sac@pocintmed.com.br>
Data: 2021-01-07 13:59

- Pesquisa de preços 3-2021.pdf (~210 KB)

Boa dia,

Segue PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021 PARA COMPRA DIRETA.

Obs. Favor enviar a proposta conforme o anexo I.

Att

Juizela



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
 Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65
 CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
 Tel: (49) 3565-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

ANEXO I

PESQUISA DE PREÇOS Nº 3/2021. PARA COMPRA DIRETA

I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE

Razão Social: HAND SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Endereço: Rua Ronaldo de Carvalho, 41.
Bairro: Fidelis **Município:** Blumenau - SC **CEP:** 89.060-120
Fone/Fax: (47)99911-1055
E-mail: paulo.tillmann4@gmail.com **Home Page:**
CNPJ: 30.273.125/0001-56 **Inscrição Estadual:** 260.505.030
Banco: 085 - VIACREDI **Agência Nº** 0101-5 **Conta Corrente:** 1099.165-4

Responsável pela assinatura do contrato: PAULO SERGIO TILLMANN

Cargo: Sócio
CPF: 670.374.969-87
RG: 2.170.079 SSP -SC

II - APRESENTAÇÃO DE PREÇOS PELO VALOR GLOBAL

Os produtos cotados são para uso na prevenção do COVID-19. A empresa deve COTAR A MARCA DOS PRODUTOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS Descritivo: Analisador de Sangue portátil (Point of Care) para determinação quantitativa simultânea de elementos sanguíneos específicos, para pacientes críticos ou não críticos, totalmente automatizado que dispõe de um vasto menu de testes indicadores de diagnóstico e tratamento relacionados com a gestão do estado da doença e as linhas de orientação clínica, utilizando apenas 100ul de amostra de sangue arterial ou venoso, o sistema fornece o resultado em questão de minutos, operado em punho, pesando aproximadamente 650gramas, medindo 7,68cm X 23,48cm X 7,24cm., com controle térmico, bateria interna de lítio e calibração eletrônica. Possuir sistema de introdução de dados tipo scanner e teclado alfa-numérico, e memoriza automaticamente até 1000 registros de testes. Sua saída e transmissão de dados são feita através de infravermelho e suas funções podem ser controladas por software de gerenciamento. Utiliza como único e exclusivo	UN	1	R\$ 70.834,20	R\$ 70.834,20



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65

Inscrição Estadual: isortb

Tel: (48) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

reagente os cartuchos para
 Bioquímica/Eletrólitos/Lactato, Hematologia,
 Gasometria, Coagulação, Endocrinologia e
 Marcadores Cardíacos, sem necessidade de
 eletrodos seletivos ou troca de gás. A leitura dos
 resultados ocorre em até 2 minutos para
 Bioquímica, Eletrólitos, Lactato, Hematologia e
 Gasometria, 5 minutos para Coagulação e 10
 minutos para Endocrinologia e Marcadores
 Cardíacos. Acompanha impressora portátil para
 emissão de laudos, simulador eletrônico para
 calibração, base downloader/Recharger e
 bateria recarregável.

Inclui:

- Impressora portátil com infravermelho com pilhas recarregáveis e bobina de rolo termossensível, compatível com I-STAT.
- Downloader/Recharger para recarregar uma bateria recarregável no analisador. Se o analisador contiver uma bateria recarregável, a bateria começa a recarregar automaticamente logo que o analisador é colocado no Downloader/Recharger.

O Downloader/Recharger tem também um compartimento para recarregar uma bateria recarregável fora do analisador. • Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel.

CARTUCHOS: CARTUCHO CG4 Cartucho para exame de gasometria com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar os seguintes exames em amostras de sangue total venoso/arterial: Lactato, pH, PCO₂, PO₂, TCO₂, HCO₃, BE e SO₂. Leitura e resultado em 2 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível!

CARTUCHO cTnI Cartucho para dosagem quantitativa da Enzima Cardíaca Troponina-I (cTnI) com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar o teste de troponina cardíaca I em amostras de sangue total ou plasma, que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Leitura e resultado em 10 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível.

A proponente deverá efetuar o treinamento do pessoal que irá trabalhar com o aparelho.

Garantia mínima de 12 meses.

MARCA:



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento

Tel. (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

	TODAS AS DIMENSÕES E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS.				
TOTAL GLOBAL					R\$ R\$ 70.834,20

3 - CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

3.1. A Proposta apresentada tem validade de 15 dias, contados a partir da data de abertura da Proposta de Preços.

3.2. Prazo de entrega dos materiais: até 30 dias após o recebimento da Ordem de Compra que será via e-mail.

3.3. PAGAMENTO A VISTA após recebimento, conferência e atestado de conformidade.
(Prazo máximo de 5 (cinco) dias)

4. DECLARAÇÕES:

4.1 – Declaramos que no valor proposto já estão incluídos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, fretes, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e demais inerentes ao fornecimento dos produtos.

4.2 – Declaramos o objeto social da empresa é compatível com o fornecimento dos produtos cotados, e que os produtos cotados estão em conformidade com a descrição, e apresentam a garantia e validade nos termos da legislação.

4.3 - Declaramos que os preços aqui propostos são plenamente exequíveis e nos colocamos à disposição da Comissão de Licitações para informações complementares caso seja necessário.

4.5 - Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumprimos plenamente a legislação citada.

4.6 – Declaramos para fins de participação, e, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à participação na presente Pesquisa de Preços, e, que a empresa não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a administração. Também declara que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
Tel: (48) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

4.7 – Declaramos sob as penas da Lei, que os produtos oferecidos nesta proposta de preços, são novos, ou seja, não foram utilizados e condizem com as especificações exigidas na descrição e estão devidamente registrados nos órgãos competentes, e caso seja necessário apresentaremos laudos e registros de sua validade.

Blumenau, em 08 de janeiro de 2021.

**HAND SERVICOS,
COMERCIO E
REPRESENTACAO**

LTDA:30273125000156

Assinado de forma digital por
HAND SERVICOS, COMERCIO E
REPRESENTACAO

LTDA:30273125000156

Dados: 2021.01.11 10:18:29
-03'00'

HAND SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ: 30.273.125/0001-56

NOME DO ADMINISTRADOR: PAULO SERGIO TILLMANN

CPF: 670.374.969-87

E-mail: paulo.tillmann4@gmail.com



HAND SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ: 0.273.125/0001-56

ENDEREÇO: RUA RONALDO DE CARVALHO, 41, FIDELIS - BLUMENAU (SC)

TEL.: (47) 99911-1055

E-MAIL: contato@handlife.com.br

CLIENTE: CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS

CNPJ: 33.789.850/0007-65

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
ANALISADOR SANGUÍNEO PORTÁTIL I-STAT.	01	R\$ 47.150,40	R\$ 47.150,40
IMPRESSORA KIT I-STAT	01	R\$ 4.458,28	R\$ 4.458,28
DOWNLOADER RECHARGER I-STAT	01	R\$ 10.284,04	R\$ 10.284,04
SIMULADOR ELET. I-STAT	01	R\$ 3.714,00	R\$ 3.714,00
BATERIA RECARREGÁVEL I-STAT	01	R\$ 1.793,02	R\$ 1.793,02
CX CG4 CARTUCHO I-STAT COM 25 CART.	01	R\$ 1.321,46	R\$ 1.321,46
CX CTNI CARTUCHO I-STAT COM 25 CART.	01	R\$ 2.113,00	R\$ 2.113,00

TOTAL GERAL: R\$ 70.834,20

FRETE CIF

PRAZO DE PGTO: A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS APÓS COLOCAÇÃO DO PEDIDO.

BLUMENAU, 05 DE JANEIRO DE 2021.



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65
 CNPJ: 03.749.830/0007-05 Inscrição Estadual: isento
 Tel: (49) 3556-1111 E-mail: licitacoes@hnsadd.com.br

ANEXO I

**PESQUISA DE PREÇOS Nº 3/2021.
PARA COMPRA DIRETA**

I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE

Razão Social: MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
 Endereço: Alameda três de outubro, 785.

Bairro: Sarandi Município: Porto Alegre - RS CEP: 91.130-470

Fone/Fax: (51) 3516-9500

E-mail: medcare@medcarers.com.br

Home Page: www.medcarers.com.br

CNPJ: 04.818.528/0001-23

Inscrição Estadual: 098/2906068

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência Nº 5745-2

Conta Corrente: 16747-9

Responsável pela assinatura do contrato: ALEXSANDER CARDOSO

Cargo: SÓCIO DIRETOR

CPF: 952.330.590-53

RG: 6036624745 SSP/PC RS

II - APRESENTAÇÃO DE PREÇOS PELO VALOR GLOBAL.

Os produtos cotados são para uso na prevenção do COVID-19. A empresa deve COTAR A MARCA DOS PRODUTOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS</p> <p>Descritivo: Analisador de Sangue portátil (Point of Care) para determinação quantitativa simultânea de elementos sanguíneos específicos, para pacientes críticos ou não críticos, totalmente automatizado que dispõe de um vasto menu de testes indicadores de diagnóstico e tratamento relacionados com a gestão do estado da doença e as linhas de orientação clínica, utilizando apenas 100ul de amostra de sangue arterial ou venoso, o sistema fornece o resultado em questão de minutos, operado em punho, pesando aproximadamente 850gramas, medindo 7,88cm X 23,48cm X 7,24cm, com controle térmico, bateria interna de lítio e calibração eletrônica. Possui sistema de introdução de dados tipo scanner e teclado alfa-numérico, e memoriza automaticamente até 1000 registros de testes. Sua saída e transmissão de dados são feita através de infravermelho e suas funções podem ser controladas por software de gerenciamento. Utiliza como único e exclusivo</p>	UN	1	R\$ 63.167,90	R\$ 63.167,90



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65
 CNPJ: 08.789.650/0007-65 Inscricao Estadual: Isento
 Tel: (49) 3555-1111 E-mail: galacoes@hnsjedd.com.br

<p>reagente os cartuchos para para Bioquímica/Eletrólitos/Lactato, Hematologia, Gasometria, Coagulação, Endocrinologia e Marcadores Cardíacos, sem necessidade de eletrodos seletivos ou troca de gás. A leitura dos resultados ocorre em até 2 minutos para Bioquímica, Eletrólitos, Lactato, Hematologia e Gasometria, 3 minutos para Coagulação e 10 minutos para Endocrinologia e Marcadores Cardíacos. Acompanha impressora portátil para emissão de laudos, simulador eletrônico para calibração, base downloader/Recharger e bateria recarregável.</p> <p>Inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impressora portátil com infravermelho com pilhas recarregáveis e bobina de rolo termossensível, compatível com I-STAT. • Downloader/Recharger para recarregar uma bateria recarregável no analisador. Se o analisador contiver uma bateria recarregável, a bateria começa a recarregar automaticamente logo que o analisador é colocado no Downloader/Recharger. <p>O Downloader/Recharger tem também um compartimento para recarregar uma bateria recarregável fora do analisador. • Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel.</p> <p>CARTUCHOS: CARTUCHO CG4 Cartucho para exame de gasometria com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar os seguintes exames em amostras de sangue total venoso/arterial: Lactato, pH, PCO₂, PO₂, TCO₂, HCO₃, BE e SO₂. Leitura e resultado em 2 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível!</p> <p>CARTUCHO cTnI Cartucho para dosagem quantitativa da Enzima Cardíaca Troponina-I (cTnI) com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar o teste da troponina cardíaca I em amostras de sangue total ou plasma, que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Leitura e resultado em 10 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível.</p> <p>A proponente deverá efetuar o treinamento do pessoal que irá trabalhar com o aparelho.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses. MARCA: I-STAT / ABBOTT</p>			
--	--	--	--



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65
CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscricão Estadual Isento
Tel: (41) 3665-1111 E-mail: licitacoes@hnsd.com.br

	<p>TODAS AS DIMENSÕES E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS.</p>				
TOTAL GLOBAL					R\$ 63.167,90

3 - CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

- 3.1. A Proposta apresentada tem validade de 15 dias, contados a partir da data de abertura da Proposta de Preços.
- 3.2. Prazo de entrega dos materiais: até 30 dias após o recebimento da Ordem de Compra que será via e-mail.
- 3.3. **PAGAMENTO A VISTA** após recebimento, conferência e atestado de conformidade. (Prazo máximo de 5 (cinco) dias)

4. DECLARAÇÕES:

- 4.1 - Declaramos que no valor proposto já estão incluídos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, fretes, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e demais inerentes ao fornecimento dos produtos.
- 4.2 - Declaramos o objeto social da empresa é compatível com o fornecimento dos produtos cotados, e que os produtos cotados estão em conformidade com a descrição, e apresentam a garantia e validade nos termos da legislação.
- 4.3 - Declaramos que os preços aqui propostos são plenamente exequíveis e nos colocamos à disposição da Comissão de Licitações para informações complementares caso seja necessário.
- 4.5 - Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumprimos plenamente a legislação citada.
- 4.6 - Declaramos para fins de participação, e, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à participação na presente Pesquisa de Preços, e, que a empresa não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a administração. Também declara que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
- 4.7 - Declaramos sob as penas da Lei, que os produtos oferecidos nesta proposta de preços, são novos, ou seja, não foram utilizados e condizem com as especificações exigidas na descrição e estão devidamente registrados nos órgãos competentes, e caso seja necessário apresentaremos laudos e registros de sua validade.

Porto Alegre, em 11 de janeiro de 2021.



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.890/0007-69 Inscrição Estadual: 140400
Tel: (49) 3655-1111 E-mail: hospital@hredd.com.br


MEDCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 04.818.528/0001-23

04.818.528/0001-23

ALEXSANDER Assinado de forma digital
por ALEXSANDER
CARDOSO:95 CARDOSO:95233059053
233059053 Dados: 2021.01.11
13:06:15 -03'00'

**MEDCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI**
ALAMEDA TRÊS DE OUTUBRO, 795
SARANDI - CEP 91130-470
PORTO ALEGRE - RS

NOME DO ADMINISTRADOR: ALEXSANDER CARDOSO
CPF: 852.330.590-53
E-mail: alexsander@medcarens.com.br



MEDICARE - MEDICARE COM. DE PRODS. MÉDICO HOSP. EIRELI

End.: Nº - - - Cep: - Cnpj: 04618526000123 - Email: medicare@medcarers.com.br - Tel: - Repres
 ontante: FRANCISCO FLOR - FRANCISCO ADELIR FLOR - Email: francisco@handlife.com.br - Tel.: (047) 99511-1655,

ORÇAMENTO #04458 - Aberto

DADOS DO CLIENTE

Código 33789850000765	Nome Fantasia HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	Razão Social CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
Endereço R WILSON BORDIN		Nº 48
Bairro CENTRO	Complimento	
Cidade CAPINZAL	UF SC	CEP 89665-000
	CNPJ/CPF 33.789.850/0007-65	IE/IRG
Telefone (049) 3555-1111	Email cristianebonetti@yafon.com.br	

PAGAMENTO

Forma de pagamento
AVISTA

ITENS DO ORÇAMENTO

SEQ	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VL UNIT. LF BESC	TOTAL
1	04P75-01 - I-STAT 1 ANALYSER - ANALISADOR	Un.	1	41.800,00	41.800,00
2	04P74-04 - I-STAT 1 KIT DE IMPRESSORA	Un.	1	3.970,00	3.970,00
3	06F11-01 - I-STAT SIMULADOR ELETRONICO	Un.	1	3.050,00	3.050,00
4	04P73-04 - I-STAT DOWNLOADER RECHARGER DRC-300	Un.	1	9.890,00	9.890,00
5	06F23-55 - I-STAT 1,9V NIMH BATTERY - BATERIA RECARREGÁVEL DE HIDRETO METALICO DE NIQUEL	Un.	1	1.680,00	1.680,00
6	CG4 - I-STAT CARTUCHO CG4 - C/25 CARTUCHOS	Un.	1	987,90	987,90
7	CTN1 - I-STAT CARTUCHO TROPONINA CTN1 C/25 CARTUCHOS	Un.	1	1.790,00	1.790,00

TOTAIS

Qtd Itens 7	Tot. un. alocac. 63.167,90
----------------	-------------------------------

Total: 63.167,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data de Previsão:

Informações adicionais:
 TREINAMENTO INCLUSO
 PAGAMENTO AVISTA

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____ QTDE ITENS: 7 VALOR TOTAL PEDIDO: 63.167,90



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA
REPARADORAS

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

ANÁLISE

**PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021.
PARA COMPRA DIRETA**

Foram analisadas as propostas recebidas relativas a pesquisa de preços em epígrafe, conforme segue:

**EMPRESA VENCEDORA: MEDCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES EIRELI**

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	QUANT	Valor unitário	Valor Total
1	ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS Descritivo: Analisador de Sangue portátil (Point of Care) para determinação quantitativa simultânea de elementos sanguíneos específicos, para pacientes críticos ou não críticos, totalmente automatizado que dispõe de um vasto menu de testes indicadores de diagnóstico e tratamento relacionados com a gestão do estado da doença e as linhas de orientação clínica, utilizando apenas 100ul de amostra de sangue arterial ou venoso, o sistema fornece o resultado em questão de minutos, operado em punho, pesando aproximadamente 650gramas, medindo 7,68cm X 23,48cm X 7,24cm., com controle térmico, bateria interna de lítio e calibração eletrônica. Possuir sistema de introdução de dados tipo scanner e teclado alfa-numérico, e memoriza automaticamente até 1000 registros de testes. Sua saída e transmissão de dados são feita através de infravermelho e suas funções podem ser	UN	1	R\$ 63.167,90	R\$ 63.167,90



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA
REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 33.789.850/0007-65

Inscrição Estadual: Isento

Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

controladas por software de gerenciamento. Utiliza como único e exclusivo reagente os cartuchos para Bioquímica/Eletrólitos/Lactato, Hematologia, Gasometria, Coagulação, Endocrinologia e Marcadores Cardíacos, sem necessidade de eletrodos seletivos ou troca de gás. A leitura dos resultados ocorre em até 2 minutos para Bioquímica, Eletrólitos, Lactato, Hematologia e Gasometria, 5 minutos para Coagulação e 10 minutos para Endocrinologia e Marcadores Cardíacos. Acompanha impressora portátil para emissão de laudos, simulador eletrônico para calibração, base downloader/Recharger e bateria recarregável.

Inclui:

- Impressora portátil com infravermelho com pilhas recarregáveis e bobina de rolo termossensível, compatível com I-STAT.

- Downloader/Recharger para recarregar uma bateria recarregável no analisador. Se o analisador contiver uma bateria recarregável, a bateria começa a recarregar automaticamente logo que o analisador é colocado no Downloader/Recharger.

O Downloader/Recharger tem também um compartimento para recarregar uma bateria recarregável fora do analisador. • Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel.

CARTUCHOS: CARTUCHO CG4
Cartucho para exame de gasometria com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA
REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

CNPJ: 33.789.860/0007-65

Inscrição Estadual: Isento

Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

<p>realizar os seguintes exames em amostras de sangue total venoso/arterial: Lactato, pH, PCO₂, PO₂, TCO₂, HCO₃, BE e SO₂. Leitura e resultado em 2 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível</p> <p>CARTUCHO cTnI Cartucho para dosagem quantitativa da Enzima Cardíaca Troponina-I (cTnI) com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar o teste de troponina cardíaca I em amostras de sangue total ou plasma, que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Leitura e resultado em 10 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível.</p> <p>A proponente deverá efetuar o treinamento do pessoal que irá trabalhar com o aparelho.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses. MARCA: I-STAT / ABBOTT TODAS AS DIMENSÕES E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS.</p>				
--	--	--	--	--

Para a decisão da comissão de licitação foram levados em consideração os parâmetros estabelecidos no edital de pesquisa de preços N° 03/2021, em especial o menor preço oferecido.

É importante registrar que a presente pesquisa de preços, além de ser publicada no sítio do hospital na internet, também foi publicada no mural de avisos do hospital, e, também foi enviada para diversos fornecedores.

Capinzal, 14 de janeiro de 2021.

Eu, Gracieli Dambros, Gracieli Dambros digitei a presente ata e os demais membros:
Celi Eliane Antunes Celi Antunes e Edione Panisson Rosset
Edione Panisson Rosset conferiram



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
Certificado de Filantropia - Processo nº
 CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
 Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

RESULTADO

PESQUISA DE PREÇOS Nº 03/2021. PARA COMPRA DIRETA

A CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS, HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC, informa o resultado da **pesquisa de preços em epígrafe para compra direta.**

Os recursos para a aquisição do objeto da presente pesquisa de preços são provenientes do **Contrato nº 107/2020 – SES 70386/2020 – Secretaria de Estado da Saúde** destinados ao combate da pandemia da COVID-19.

EMPRESA VENCEDORA: MEDCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	QUANT	Valor unitário	Valor Total
1	ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS Descritivo: Analisador de Sangue portátil (Point of Care) para determinação quantitativa simultânea de elementos sanguíneos específicos, para pacientes críticos ou não críticos, totalmente automatizado que dispõe de um vasto menu de testes indicadores de diagnóstico e tratamento relacionados com a gestão do estado da doença e as linhas de orientação clínica, utilizando apenas 100ul de amostra de sangue arterial ou venoso, o sistema fornece o resultado em questão de minutos, operado em punho, pesando aproximadamente 650gramas, medindo 7,68cm X 23,48cm X 7,24cm., com controle térmico, bateria interna de lítio e calibração eletrônica. Possuir sistema de introdução de dados tipo scanner e teclado alfa-numérico, e memoriza automaticamente até 1000 registros de testes. Sua	UN	1	R\$ 63.167,90	RS 63.167,90



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Certificado de Filantropia - Processo nº

CNPJ: 33.789.850/0007-85

Inscrição Estadual: Isento

Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

saída e transmissão de dados são feita através de infravermelho e suas funções podem ser controladas por software de gerenciamento. Utiliza como único e exclusivo reagente os cartuchos para Bioquímica/Eletrólitos/Lactato, Hematologia, Gasometria, Coagulação, Endocrinologia e Marcadores Cardíacos, sem necessidade de eletrodos seletivos ou troca de gás. A leitura dos resultados ocorre em até 2 minutos para Bioquímica, Eletrólitos, Lactato, Hematologia e Gasometria, 5 minutos para Coagulação e 10 minutos para Endocrinologia e Marcadores Cardíacos. Acompanha impressora portátil para emissão de laudos, simulador eletrônico para calibração, base downloader/Recharger e bateria recarregável.

Inclui:

- Impressora portátil com infravermelho com pilhas recarregáveis e bobina de rolo termossensível, compatível com I-STAT.

- Downloader/Recharger para recarregar uma bateria recarregável no analisador. Se o analisador contiver uma bateria recarregável, a bateria começa a recarregar automaticamente logo que o analisador é colocado no Downloader/Recharger.

O Downloader/Recharger tem também um compartimento para recarregar uma bateria recarregável fora do analisador. • Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel.

CARTUCHOS: CARTUCHO CG4
 Cartucho para exame de gasometria com tecnologia de



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Certificado de Filantropia - Processo nº

CNPJ: 33.789.850/0007-66

Inscrição Estadual: Isento

Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

<p>micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar os seguintes exames em amostras de sangue total venoso/arterial: Lactato, pH, PCO—2, PO2, TCO2, HCO3, BE e SO2. Leitura e resultado em 2 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível</p> <p>CARTUCHO cTnI Cartucho para dosagem quantitativa da Enzima Cardíaca Troponina-I (cTnI) com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar o teste de troponina cardíaca I em amostras de sangue total ou plasma, que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Leitura e resultado em 10 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível.</p> <p>A proponente deverá efetuar o treinamento do pessoal que irá trabalhar com o aparelho.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>MARCA: I-STAT / ABBOTT</p> <p>TODAS AS DIMENSÕES E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS.</p>				
--	--	--	--	--

Capinzal, 14 de janeiro de 2021.

ADELAIDE
 FRIGO:80886809720

Assinada de forma eletrônica por:
 ADELAIDE FRIGO:80886809720
 Data: 14/01/2021 10:44:23

ADELAIDE FRIGO
 Diretora



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

ORDEM DE COMPRA

**PESQUISA DE PREÇOS Nº 3/2021.
PARA COMPRA DIRETA**

A CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS, HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC, **autoriza a compra relativa a pesquisa de preços para compra direta em epígrafe.**

Os recursos para a aquisição do objeto da presente pesquisa de preços são provenientes do **Contrato nº 107/2020 – SES 70386/2020** – Secretaria de Estado da Saúde destinados ao combate da pandemia da COVID-19.

FORNECEDOR: MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMNETOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS</p> <p>Descritivo: Analisador de Sangue portátil (Point of Care) para determinação quantitativa simultânea de elementos sanguíneos específicos, para pacientes críticos ou não críticos, totalmente automatizado que dispõe de um vasto menu de testes indicadores de diagnóstico e tratamento relacionados com a gestão do estado da doença e as linhas de orientação clínica, utilizando apenas 100ul de amostra de sangue arterial ou venoso, o sistema fornece o resultado em questão de minutos, operado em punho, pesando aproximadamente 650gramas, medindo 7,68cm X 23,48cm X 7,24cm., com controle térmico, bateria interna de lítio e calibração eletrônica. Possuir sistema de Introdução de dados tipo scanner e teclado alfa-numérico, e memoriza automaticamente até 1000 registros de testes. Sua saída e transmissão de dados são feita através de Infravermelho e suas funções podem ser controladas por software de gerenciamento. Utiliza como único e exclusivo reagente os cartuchos para Bioquímica/Eletrólitos/Lactato, Hematologia, Gasometria, Coagulação, Endocrinologia e Marcadores Cardíacos, sem necessidade de eletrodos seletivos ou troca de gás. A leitura dos resultados ocorre em até 2 minutos para Bioquímica, Eletrólitos, Lactato, Hematologia e Gasometria, 5 minutos para Coagulação e 10 minutos para Endocrinologia e Marcadores</p>	UN	1	R\$63.167,90	R\$63.167,90



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

<p>Cardiacos. Acompanha impressora portátil para emissão de laudos, simulador eletrônico para calibração, base downloader/Recharger e bateria recarregável.</p> <p>Inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impressora portátil com infravermelho com pilhas recarregáveis e bobina de rolo termossensível, compatível com I-STAT. • Downloader/Recharger para recarregar uma bateria recarregável no analisador. Se o analisador contiver uma bateria recarregável, a bateria começa a recarregar automaticamente logo que o analisador é colocado no Downloader/Recharger. <p>O Downloader/Recharger tem também um compartimento para recarregar uma bateria recarregável fora do analisador. • Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel.</p> <p>CARTUCHOS: CARTUCHO CG4 Cartucho para exame de gasometria com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar os seguintes exames em amostras de sangue total venoso/arterial: Lactato, pH, PCO₂, PO₂, TCO₂, HCO₃, BE e SO₂. Leitura e resultado em 2 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível</p> <p>CARTUCHO cTnI Cartucho para dosagem quantitativa da Enzima Cardíaca Troponina-I (cTnI) com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar o teste de troponina cardíaca I em amostras de sangue total ou plasma, que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Leitura e resultado em 10 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível.</p> <p>A proponente deverá efetuar o treinamento do pessoal que irá trabalhar com o aparelho.</p>				
TOTAL GLOBAL				R\$63.167,90

Capinzal, 19 de janeiro de 2021.

ADELAIDE
FRIGO:80886809720

Assinatura eletrônica digitalizada ADELAIDE
FRIGO:80886809720
Data: 2021-01-19 15:33:05

Adelaide Frigo
Diretora



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
 Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

TERMO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

PESQUISA DE PREÇOS Nº 3/2021. PARA COMPRA DIRETA

A Comissão de Recebimento de produtos e serviços oriundos de Licitações e cotações eletrônicas de preços, designada pela Resolução nº 2/2021, ATESTA para os devidos fins e efeitos, nos termos da lei, que o(s) produto(s) aqui identificados, foram recebidos e estão em conformidade com a marca, quantidade, peso, preços e demais especificações constantes na Ordem de Serviço, bem como notas fiscais nº 45196, estando assim regulares e em conformidade com aquilo que foi exigido na pesquisa de preços para compra direta em epígrafe, com parecer para sua aceitação.

FORNECEDOR: MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMNETOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS</p> <p>Descritivo: Analisador de Sangue portátil (Point of Care) para determinação quantitativa simultânea de elementos sanguíneos específicos, para pacientes críticos ou não críticos, totalmente automatizado que dispõe de um vasto menu de testes indicadores de diagnóstico e tratamento relacionados com a gestão do estado da doença e as linhas de orientação clínica, utilizando apenas 100ul de amostra de sangue arterial ou venoso, o sistema fornece o resultado em questão de minutos, operado em punho, pesando aproximadamente 650gramas, medindo 7,68cm X 23,48cm X 7,24cm., com controle térmico, bateria interna de lítio e calibração eletrônica. Possuir sistema de introdução de dados tipo scanner e teclado alfa-numérico, e memoriza automaticamente até 1000 registros de testes. Sua saída e transmissão de dados são feita através de infravermelho e suas funções podem ser controladas por software de gerenciamento. Utiliza como único e exclusivo reagente os cartuchos para Bioquímica/Eletrólitos/Lactato, Hematologia, Gasometria, Coagulação, Endocrinologia e Marcadores Cardíacos, sem necessidade de eletrodos seletivos ou troca de gás. A leitura dos resultados ocorre em até 2 minutos para Bioquímica, Eletrólitos, Lactato, Hematologia e Gasometria, 5 minutos para Coagulação e 10 minutos para Endocrinologia e Marcadores Cardíacos. Acompanha impressora portátil para emissão de laudos, simulador eletrônico</p>	UN	1	R\$63.167,90	R\$63.167,90



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

	<p>para calibração, base downloader/Recharger e bateria recarregável.</p> <p>Inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impressora portátil com infravermelho com pilhas recarregáveis e bobina de rolo termossensível, compatível com I-STAT. • Downloader/Recharger para recarregar uma bateria recarregável no analisador. Se o analisador contiver uma bateria recarregável, a bateria começa a recarregar automaticamente logo que o analisador é colocado no Downloader/Recharger. <p>O Downloader/Recharger tem também um compartimento para recarregar uma bateria recarregável fora do analisador. • Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel.</p> <p>CARTUCHOS: CARTUCHO CG4 Cartucho para exame de gasometria com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar os seguintes exames em amostras de sangue total venoso/arterial: Lactato, pH, PCO₂, PO₂, TCO₂, HCO₃, BE e SO₂. Leitura e resultado em 2 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível</p> <p>CARTUCHO cTnI Cartucho para dosagem quantitativa da Enzima Cardíaca Troponina-I (cTnI) com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar o teste de troponina cardíaca I em amostras de sangue total ou plasma, que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Leitura e resultado em 10 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível.</p> <p>A proponente deverá efetuar o treinamento do pessoal que irá trabalhar com o aparelho.</p>				
TOTAL GLOBAL					R\$63.167,90

Capinzal, em 21 de janeiro de 2021.

Aline Urbano Moraes
Aline Urbano Moraes
Presidente

Stefani F. Surdi
Stefani Furtado Surdi
Membro

Everton Dambrós
Everton Dambrós
Membro



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **20/02/2021**

Nome: MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO

CNPJ: 04.818.528/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 14 de janeiro de 2021.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Certidão emitida em 21/01/2021 às 08:20:40, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 04.818.528/0001-23** e o código de autenticidade **DE597F4C1EC3**



Certidão de Situação Fiscal nº 0016086173

Identificação do titular da certidão:

Nome: **MEDCARE COM PROD EQUIP MEDICO HOSPITS EIRELI**
Endereço: **AL TRES DE OUTUBRO, 785, 795
SARANDI, PORTO ALEGRE - RS**
CNPJ: **04.818.528/0001-23**

Certificamos que, aos **06** dias do mês de **JANEIRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 6/3/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0025914790**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 04.818.528/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:09 do dia 28/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/03/2021.

Código de controle da certidão: **A3F0.D64A.4D40.F61C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Votar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 04.818.528/0001-23**Razão Social:** MEDCARE PRODUTOS E EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA**Endereço:** AL TRES DE OUTUBRO 795 / SARANDI / PORTO ALEGRE / RS / 91130-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/01/2021 a 05/02/2021**Certificação Número:** 2021010702172837341036

Informação obtida em 20/01/2021 14:53:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.818.528/0001-23
Certidão nº: 20033663/2020
Expedição: 13/08/2020, às 16:10:47
Validade: 08/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.818.528/0001-23**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assunto **Treinamento I-stat - Hospital Nossa Senhora das Dores;**
De <francisco@medcarers.com.br>
Para 'Cristiane Bonetti' <cristianebonetti@yahoo.com.br>
Cópia <licitacoes@hnsdd.com.br>, 'Paulo Sergio Tillmann' <paulo@medcarers.com.br>, 'Ariane SilveiraTillmann' <nanetillmann214@gmail.com>
Data 2021-01-21 18:46



- Catálogo 5.pdf (~1,5 MB)
- Processo teste I-Stat.pdf (~512 KB)
- Prot.AVC (2).pdf (~593 KB)
- UTF-8"Prot.%20Dor%20tor%C3%A1tica.pdf (~434 KB)
- Prot. Sepsis.pdf (~472 KB)
- Código de erros.pdf (~571 KB)
- Manual do Sistema.pdf (~10 MB)

Boa tarde Cris e Gracieli;

Estou aqui confirmando o treinamento prático do Equipamento I-stat, para o dia 26/01 no horário das 9:00hs as 18:00hs;

Favor comunicar todos setores envolvidos que iram utilizar o equipamento.

Sugestão:

Centro Cirúrgico;
Pronto Atendimento;
UTI
Laboratório e outros;

O Treinamento será ministrado pela Enfermeira Ariane que nos lê cópia.
Enfermeira gentileza procurar a Srta Cristiane (Gerente Enfermagem), ela irá acompanhar durante o treinamento.

Endereço do hospital:

Rua: Dr Vilson Bordin 48, Capinzal.

Fico seu dispor para qualquer esclarecimento!

Att;

Anexo alguns material;

Francisco A. Flor

Representate Comercial


MedCare Comércio de Produtos e Equipamentos Médico Hospitalares EIRELI

Matriz: Al. Três de outubro, 795 – Sarandi – Porto Alegre/RS – Brasil – CEP: 91130-470

Filial: Rodovia BR-101, 9245 - Galpão B - Cidade Nova – Itajaí/SC – Brasil – CEP: 88308-620

(+55 51) 3365-7769 | 3019-7778

(+55 47) 99911 1055

francisco@medcarers.com.br | www.medcarers.com.br |  [Instagram](#)

Autorização no MS: 3.04993.1


Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o meio ambiente.

ESTEJA PRESENTE. ESTEJA CONFIANTE.COM I-STAT.


- O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.
- O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.
- O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.
- O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.
- O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.

COMPONENTES DE UM LABORATORIO DE GRANDE ESCALA EM UM CARTUCHO ANALISADOR COMPACTO.

- O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.
- O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.
- O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.



• O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.




• O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.



OPÇÕES DO CARTUCHO I-STAT

• O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.



• O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.

Sistema i-STAT®

ESTEJA PRESENTE. ESTEJA CONFIANTE.



• O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.

• O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.

• O novo sistema de análise de urina i-STAT oferece resultados em segundos, com alta precisão e confiabilidade.

ABRANGENTE, PORÉM PORTÁTIL:
O SISTEMA I-STAT

FORNECENDO RESULTADOS QUE
VOCÊ ENTENDE E PODE CONFIAR.

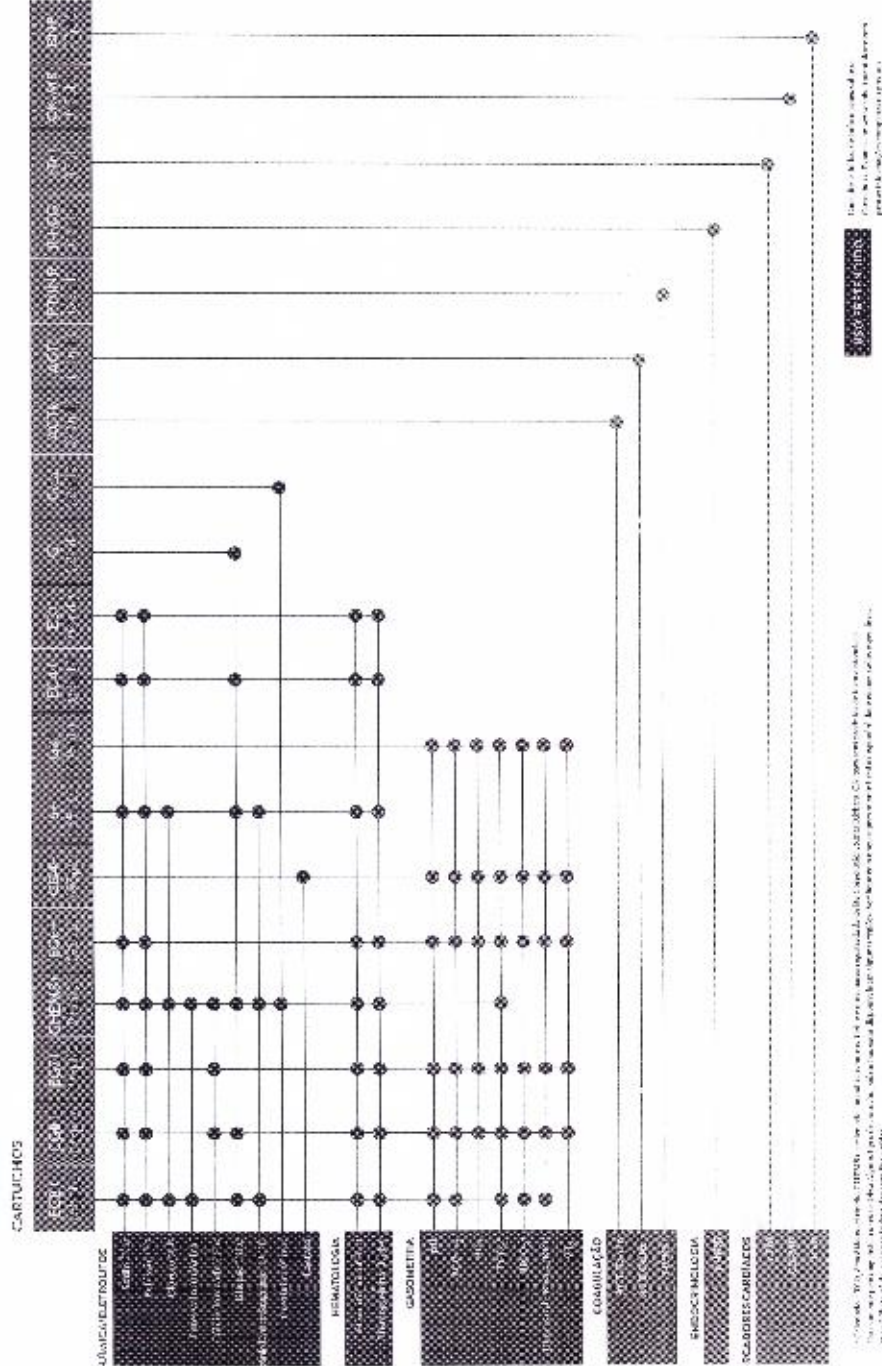

1980-2014-60196

Selecção de exames em
Obras de Engenharia em
Projetos de Engenharia


Selecção de exames em
Obras de Engenharia em
Projetos de Engenharia

Selecção de exames em
Obras de Engenharia em
Projetos de Engenharia

PROCESSO DE TESTE DO i-STAT®

POINT OF CARE

i-STAT




- 1. LIGUE O i-STAT**
-> aperte o i-STAT inserindo o Cartucho i-STAT
- 2. PREPARE O CARTUCHO**
- Levante o i-STAT e o i-STAT de operador e vá para a parte inferior de abertura e enclaque o cartucho.
- 3. MISTURE A MOSTRA IMEDIATAMENTE APÓS O PREENCHIMENTO DO CARTUCHO**
- Após a inserção da amostra, forme o bolo e misture o ponto de teste. (Se necessário, misture).
- 4. PREENCHA O CARTUCHO ATÉ A MARCA INDICADORA DE PREENCHIMENTO**
- até ao nível indicado.
- 5. FECHE O CARTUCHO**
- Após fechar, ative o sensor de cartucho.
- Levante o i-STAT e o i-STAT de operador e vá para a parte inferior de abertura e enclaque o cartucho.
- 6. INSIRA O CARTUCHO PREENCHIDO**
- Coloque o i-STAT no i-STAT e vá para a parte inferior de abertura e enclaque o cartucho.
- Após a inserção da amostra, forme o bolo e misture o ponto de teste. (Se necessário, misture).

CARTUCHO COMPLETO




CARTUCHO SEMI-TERMINADO




Este material fornece apenas um resumo geral do processo de teste do i-STAT. Para obter informações completas sobre o produto do Sistema i-STAT e documentos de suporte, consulte o seguinte endereço de Internet: www.abbottdiagnostics.com. Caso queira receber as informações mais recentes sobre diagnósticos e pontos de venda Abbott, registre seu e-mail e seu telefone corporativo para receber informações.

© 2005 Abbott
 Diagnostic Division
 Abbott Park, IL 60014



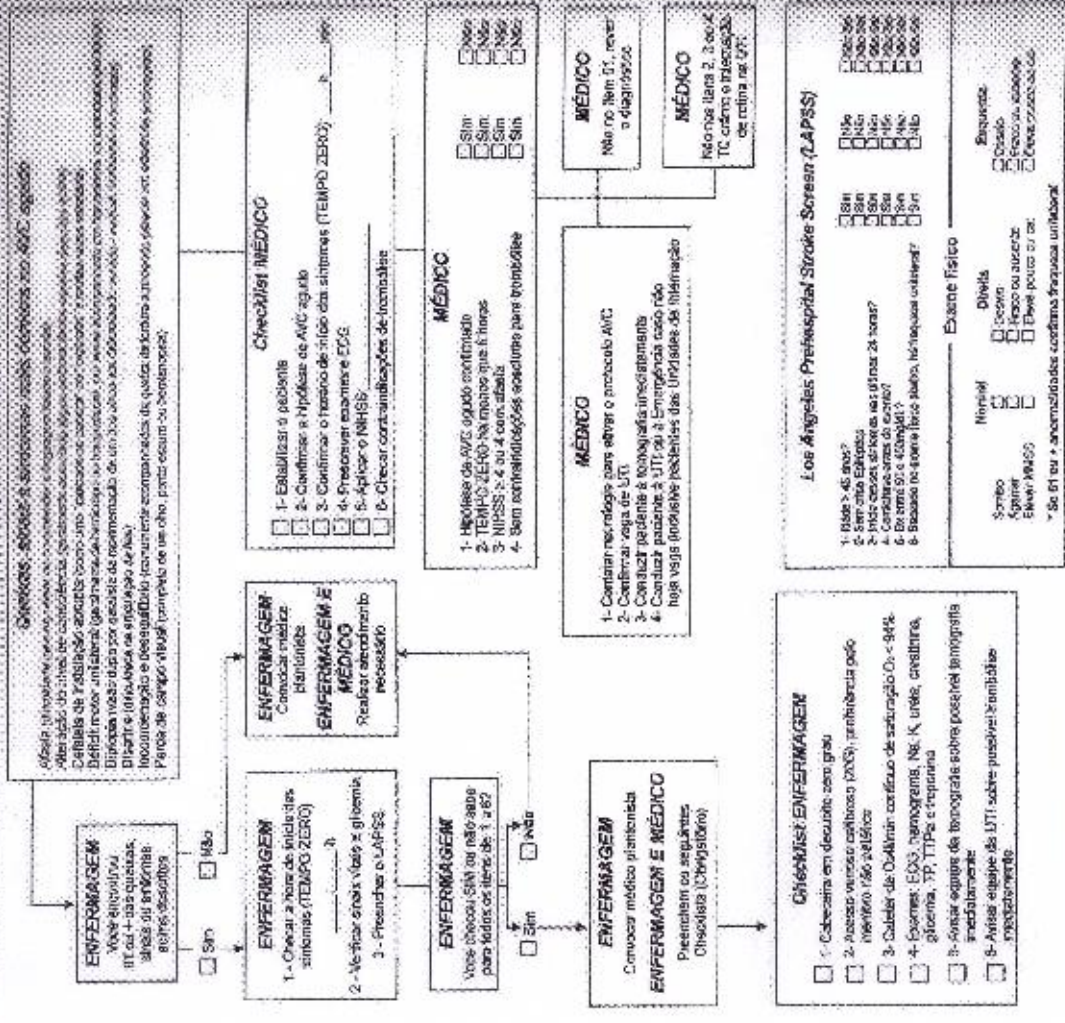

Cartucho cTnI - cartucho descartável para uso no analisador i-STAT 1 capaz de realizar simultaneamente os testes de sódio, potássio, cloro, dióxido de carbono, glicose, uréia, creatinina, cálcio iônico, hematócrito e hemoglobina em amostras de sangue total. Indicado para diagnosticar distúrbios metabólicos nos pacientes. Tempo de leitura: dois minutos



Cartucho cTnI - cartucho descartável para uso no analisador i-STAT 1 capaz de realizar o teste diagnóstico para a presença presumível de infarto agudo do miocárdio. Tempo de leitura: dois minutos

Critérios*

- Dor pleurática em aperto/apertado
- Dor aguda em aperto/queixada
- Disúria súbita > 40 g/mc

Recepção PS
Trilagem Global de PS

Enfermagem

- Verificar critérios*
- Análise de SGA/esp/dep/Alim/dep
- Análise de medicação
- Alterar ficha de Protocolo de dor Tolerável se confirmado inclusão no protocolo.

Hora do início da dor: _____ h: _____ min

Hora da chegada no Hospital: _____ h: _____ min

AValiação Médico PS
(em até 10 min.)

DOR TORÁCICA ANGIOSA ou PROVAVELMENTE ANGIOSA

Enfermagem

- Calcular o D-dímero, corrigido se saturação O₂ < 92%
- Monitorar o paciente e ECG
- Acesso venoso calibroso (20G), preferencialmente MSE

Médico PS

h: _____ min. Deleta E-Streamo
PSG, U, O, M, K, T, P, IRG, Inocaine, Gasima, Iptropina, Ox. nasal em até 3h a 5h.

h: _____ min. Rx Tox. Pa no lab. (em até 30 min.)

Medicações a critério médico:

- AAS 300 mg
- Morfina IV
- Nitroglicrina SL
- Beta-bloqueador VC
- Tienopidilol VC

ECG com Supra ST em ERE novo

ATC primária disponível em < 50 min?

Não

Sim

Resolução Clínica e ECG

Não

Sim

SDA evidente?

Não

Sim

Enfermagem

Qualificação com o setor de Hemodinâmica

Início da ATC: _____ h: _____ min.

Tempo porta - A/C: até 60min.

ALTA: Cardiologista Chave:

- AVS / diplo antiagregado plaquetário
- Avaliação de complicações pós-procedimento
- O baixo ruído
- Escala
- IECG / RRA se indicado
- Orientação multipassagem de alto

Terapêutica Fibrinolítica

Início: _____ h: _____ min.

Tempo porta-ajuda até 30min.

Avaliar comandatizáveis

Contato e Encaminhar para a UTI

Não

Sim


Médico PS: Tempo máximo de decisão: até

Resultado 1ª amostra marcadores PS: _____ h: _____ min.

ECG isêmico (chegada e + 2hs)

Marcadores moleculares (amostra de chegada e + 2hs)

A critério médico: Interrupção STI Não interromper





i-STAT[®] BOLETIM TÉCNICO

MENSAGENS CODIFICADAS DO ANALISADOR

Desde a primeira vez que é ligado até à altura em que é desligado, o analisador i-STAT[®] Analyzer efectua várias verificações de qualidade. Caso se verifique uma falha numa das verificações de qualidade, o analisador interrompe o ciclo de teste e apresenta uma mensagem a indicar a "causa", a "acção" e um código.

A mensagem sobre a causa:

Esta mensagem descreve a causa mais provável da falha da verificação de qualidade. Por exemplo, quando se detecta um cartucho demasiado cheio, o analisador irá apresentar a mensagem "Amostra posicionada para além da marca de enchimento".

A mensagem sobre a acção:

Esta mensagem indica a acção apropriada que deve ser efectuada. Por exemplo, se existirem grandes probabilidades de a verificação de qualidade voltar a falhar da próxima vez que o analisador for utilizado, será apresentada a instrução "Utilizar o simulador electrónico". Caso o problema esteja relacionado com o operador ou cartucho, será apresentada a instrução "Utilizar outro cartucho".

O código da causa:

Consiste num código numérico que está associado à falha da verificação de qualidade. Uma vez que é possível associar vários códigos a uma única mensagem de causa, estes códigos são informações essenciais quando se contacta os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local. Os códigos ficam memorizados na memória do analisador em conjunto com outros registos de testes e são transmitidos para a Estação Central de Dados. É possível visualizar e imprimir a lista de códigos.

Os códigos 1 a 15 e 95 indicam normalmente a situação relacionada com o ambiente ou o estado do analisador. Estas situações são normalmente benignas e desaparecem depois de se introduzir o cartucho seguinte ou um Simulador Electrónico, ou depois da situação irregular ser corrigida.

Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
1	Baterias sem carga / Substituir baterias	Não há energia suficiente na bateria para completar o ciclo de testes. Substituir as baterias de lítio descartáveis localizadas no analisador ou recarregar as baterias recarregáveis. Se este código ocorrer com frequência e se estiverem a ser utilizadas baterias descartáveis com o analisador i-STAT 1, deve ser considerada a hipótese de utilizar o sistema de bateria recarregável disponível com o analisador i-STAT 1 Analyzer.

Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
2	Temperatura fora dos limites / Verificar página de estado	O analisador está a registar uma temperatura fora dos limites de funcionamento. Deslocar o analisador para uma área dentro da temperatura de funcionamento aplicável ao teste que está a ser analisado e permitir que o analisador atinja a nova temperatura ambiente. Verificar a leitura da temperatura do analisador na página do estado.
3	Novo software instalado / Utilizar o simulador electrónico	Esta mensagem surge no Analisador Clínico Portátil após a instalação do novo software ou, em alguns casos, quando se recebe um novo perfil de configuração personalizada.
4, 8	Analisador interrompido / Utilizar outro cartucho	O analisador detectou que o último ciclo de testes não estava concluído. Isto pode acontecer se as baterias tiverem sido retiradas ou se estiverem a fazer mau contacto, enquanto ainda estiver um cartucho no analisador. As baterias demasiado pequenas não irão fazer um contacto adequado. Verificar se as baterias estão correctamente inseridas e encaixadas no analisador; verificar a voltagem da bateria na Página de Estado do analisador e substituir se as baterias estiverem fracas. NOTA: Os resultados dos pacientes apresentados antes deste código são válidos.
5, 6, 9	Analisador interrompido / Pronto para ser utilizado	O Analisador Clínico Portátil não consegue actualizar o visor. Esta situação pode acontecer se se verificar uma falha de alimentação antes do analisador se desligar completamente. Verificar se as baterias estão correctamente inseridas e encaixadas no analisador. As baterias demasiado pequenas não irão fazer um contacto adequado. Verificar a voltagem da bateria na Página de Estado.
7	Baterias substituídas / Pronto para ser utilizado	Esta resposta é normal surgir no Analisador Clínico Portátil, quando as baterias são substituídas após a ocorrência do código 1.
10	Temperatura dentro dos limites / Pronto para ser utilizado	A temperatura está novamente dentro dos limites após a ocorrência de um código 2 no Analisador Clínico Portátil.
11	Data inválida / Verificar relógio na Página de Estado	Quando a data no relógio de tempo real precede a data de apresentação programada no software de aplicação, o código 11 é accionado. Verificar a data no relógio de tempo real. A precisão do relógio é verificada no início de um teste de coagulação. Se o relógio não estiver certo, o código 11 é accionado.
12	CLEW inválido ou fora de prazo / Consultar Manual	O software de normalização CLEW está fora de prazo. Descarregar um CLEW válido. A data no relógio de tempo real excede o prazo de validade do software CLEW. Verificar a data no relógio de tempo real.
13	CLEW inválido ou fora de prazo / Consultar Manual	O CLEW está corrompido, não é compatível com o software de aplicação (JAMS) ou não existe nenhum CLEW no analisador. Descarregar um CLEW válido. Se este código ocorrer na sequência de uma actualização de software e se a aplicação de configuração estiver activada na CDS, alterar a versão CLEW no Perfil de Configuração pela versão mais recente e voltar a transmitir o perfil para o analisador.
14	Erro no analisador / Consultar Manual	O perfil de configuração está corrompido. Voltar a transmitir o perfil de configuração. Se o código 14 ocorrer novamente, contactar os Serviços de Assistência I-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informação.
15	O código de barras não corresponde ao tipo de cartucho	O código de barras lido pelo utilizador não corresponde ao tipo de cartucho de imunoensaio indicado pelo chip de identificação no cartucho. O utilizador deverá executar outro cartucho, tendo cuidado para ler o código de barras da embalagem unitária do tipo de cartucho específico que está ser executado no analisador.
95	Teste cancelado: psic operador	Esta mensagem será apresentada nos registos dos testes memorizados no I-STAT 1 Analyzer, nos casos em que o analisador foi desligado antes de ter sido introduzida informação obrigatória.

Os códigos seguintes estão associados ao cartucho ou ao movimento do fluido dentro do cartucho. Estas situações podem estar relacionadas com o operador ou com a amostra. Na maior parte dos casos deve ser usado um novo cartucho. Se a situação persistir, especialmente se isolada a um analisador, pode ser um problema do analisador.


Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
19	Nenhum coágulo detectado / Consultar Manual	Durante o ciclo PT/INR, não foi detectado nenhum coágulo. Executar outro cartucho. Se o código 19 reaparecer, executar a amostra utilizando uma metodologia alternativa.
22, 25	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Estes códigos ocorrem apenas nos cartuchos de coagulação, nos casos em que a mistura da amostra e reagente fica comprometida. Tal pode dever-se a uma amostra insuficiente ou coagulada, ou à existência de bolhas de ar na amostra.
24	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	A resistência eléctrica do fluido calibrante (Rcal) utilizado para verificar a concentração do electrólito está fora das especificações. Esta situação pode acontecer nos casos em que a embalagem de calibrante se rompeu imediatamente antes do teste, fazendo com que a evaporação resultasse numa concentração do electrólito mais elevada. Além da concentração do electrólito, o Rcal também é afectado pela temperatura, altura e largura do segmento do fluido em relação ao sensor condutométrico. O analisador contabiliza a temperatura, mas a altura e largura do segmento do fluido podem variar de lote de cartucho para lote de cartucho. O analisador foi programado para compensar estas diferenças entre os lotes, mantendo uma média de funcionamento dos valores Rcal medidos a partir da execução dos cartuchos mais recentes. Ocasionalmente, a diferença entre os valores Rcal para dois lotes de cartuchos é suficientemente grande para causar a introdução de um novo lote para accionar o código 24 nas primeiras execuções dos cartuchos. Os erros relativos ao Código 24 deverão desaparecer à medida que a média de funcionamento é ajustada. No entanto, se o código 24 persistir durante mais do que 3 execuções de cartuchos em cada analisador, contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local.
26	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Este código ocorre quando se verifica uma falha da verificação de qualidade especificamente relacionada com a coagulação: activação prematura do substrato, níveis de substrato anormalmente baixos ou movimento inválido de fluidos.
20, 27-29, 32, 33, 40, 41, 45, 87	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Estes códigos identificam problemas relativos aos cartuchos como, por exemplo: chegada demasiado antecipada ou demasiado atrasada do fluido calibrante, ou inexistência do fluido calibrante, ou ruído nos sinais do fluido calibrante. Os códigos 20, 27, 41 e 87 podem ser causados por um contacto insuficiente que nalguns casos poderá ser corrigido através do condicionamento dos pinos no analisador, utilizando cartuchos cerâmicos de limpeza. O procedimento de condicionamento específico está descrito no final deste boletim.
42, 43	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Estes códigos indicam que o sensor condutométrico (código 42) ou o sensor amperométrico (código 43) estava fora das especificações. Tal poderá dever-se a um rebentamento prévio da embalagem de calibrante, à existência de sujidade nos eléctrodos de contacto do cartucho ou num conector no analisador.
79-81	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Estes códigos são accionados devido à existência de mau contacto entre as sondas térmicas no analisador e a área de metalização na parte traseira dos chips no cartucho. As causas são: metalização insuficiente dos chips, existência de sujidade na área de metalização ou sondas térmicas dobradas ou quebradas no analisador.

Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
21	Cartucho já rebitado / Utilizar outro cartucho	Este código indica que o analisador detectou fluido nos sensores, antes da altura indicada. Causas possíveis: manuseamento deficiente dos cartuchos (exercer pressão no centro dos cartuchos), condições de armazenamento dos cartuchos inadequadas (congelamento) ou re-execução de cartuchos usados.
31, 34, 44	Impossível posicionar a amostra / Utilizar outro cartucho	O analisador não detectou movimento da amostra nos sensores. Tal poderá dever-se à existência de um coágulo na amostra (especialmente em recém-nascidos), ao facto de a tampa de pressão do cartucho não estar bem fechada ou a um cartucho anormal.
35, 36	Amostra posicionada abaixo da marca de enchimento / Utilizar outro cartucho	O cartucho estava pouco cheio. A amostra deve chegar à marca de enchimento. Experimentar outro cartucho.
30, 37	Amostra posicionada para além da marca de enchimento / Utilizar outro cartucho	O cartucho estava demasiado cheio. A amostra estava para além da marca de enchimento. Experimentar outro cartucho.
38, 39	Amostra insuficiente / Utilizar outro cartucho	Isto é muito provavelmente devido a amostra insuficiente no orifício para amostras do cartucho, mas pode também ser provocado por bolhas na amostra. Experimentar outro cartucho e certificar-se de que existe uma quantidade suficiente de amostra no orifício para amostras.
46	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	O analisador não detectou movimento da amostra nos sensores. Tal poderá dever-se à existência de um coágulo na amostra (especialmente em recém-nascidos), ao facto de a tampa de pressão do cartucho não estar bem fechada ou a um cartucho anormal.
47	Cartucho não inserido correctamente / Reinsirir o cartucho	Este código indica que o cartucho ou o Simulador Electrónico podem não ter sido totalmente empurrados para dentro. Reinsirir o cartucho ou o Simulador Electrónico. Se o problema persistir e/ou o utilizador tiver a certeza que o cartucho ou Simulador estão correctamente inseridos, isso pode indicar um problema no analisador. Contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.
48	Erro no analisador / Consultar Manual	Este código indica que o cartucho ou o Simulador Electrónico podem ter ficado "engatados" quando foram inseridos. Empurrar o cartucho ou Simulador directamente através da porta para cartuchos. Se o problema persistir e o utilizador tiver a certeza que o cartucho ou Simulador estão correctamente inseridos, isso pode indicar um problema no analisador. Contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.
49	Detectado contacto insuficiente / Consultar Manual	O sistema detectou um problema de contacto com um dos dois pinos do conector durante a leitura do chip de identificação no cartucho de imunoensaio. Nalguns casos, esta situação poderá ser corrigida através do condicionamento dos pinos no analisador, utilizando o cartucho de condicionamento cerâmico. O procedimento de condicionamento específico está descrito no final do Boletim Técnico, Mensagens codificadas do analisador, no Manual do Sistema i-STAT 1. Nota: Se não possuir um cartucho de condicionamento cerâmico, é favor contactar o representante de Assistência.

As seguintes situações estão relacionadas com falhas eléctricas ou mecânicas no analisador.

Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
50	Erro no analisador / Utilizar simulador electrónico	<p>O motor deslocou-se para demasiado longe. A execução de um simulador poderá não detectar este problema. Executar o simulador e se o analisador passar, executar um cartucho para ver se o código ocorre novamente. Caso contrário, continuar a utilizar o analisador. Se o código ocorrer novamente, contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.</p> <p>Aquando da análise de cartuchos de imunoensaio num analisador i-STAT 1 Analyzer, este código pode estar relacionado com uma ligação eléctrica deficiente entre o i-STAT 1 Analyzer e o cartucho. Nalguns casos, esta situação poderá ser corrigida através do condicionamento dos pinos no analisador, utilizando o cartucho de condicionamento cerâmico. O procedimento de condicionamento específico está descrito no final deste boletim.</p> <p>Os códigos 126 e 128 estão, por vezes, igualmente relacionados com a ligação eléctrica. Se forem observadas várias ocorrências destas 3 códigos (50, 126 e 128) num curto período de tempo, deve-se considerar a hipótese de devolver o analisador para se proceder à respectiva reparação e substituição.</p> <p>A presença de bolhas na amostra durante a execução de cartuchos de imunoensaio poderá, em algumas circunstâncias, despoletar também este código.</p>
51	Erro no analisador / Utilizar simulador electrónico	<p>O motor deslocou-se demasiado. Executar um simulador. Se o erro ocorreu durante a execução de um cartucho ACT, executar também um cartucho. Se o código não voltar a ocorrer, continuar a utilizar o analisador. Em determinadas situações, a bateria fraca irá causar este erro em vez do código 1. Experimentar baterias novas. Se o código ocorrer novamente, contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.</p>
52	Erro no analisador / Utilizar simulador electrónico	<p>O motor parou quando se estava a deslocar. Executar um simulador. Se o erro ocorreu durante a execução de um cartucho ACT, executar também um cartucho. Se o código não voltar a ocorrer, continuar a utilizar o analisador. Se o código ocorrer novamente, contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.</p>
58-62	Erro no analisador / Utilizar simulador electrónico	<p>O analisador recupera, geralmente, destas situações de erro. Estas situações de erro podem ser detectadas pelo Simulador Electrónico. Se o analisador passar no teste do Simulador Electrónico, continuar a usá-lo. Caso contrário, verificar a voltagem das baterias e verificar o analisador com outro simulador para excluir a hipótese de um problema do simulador. Se o código persistir, contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante local para mais informações.</p>

Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
23, 53, 55-57 63, 65-68, 70, 72-74, 82, 85, 86, 89-94, 96, 97	Erro no analisador / Consultar Manual	<p>Estas são falhas mecânicas ou electrónicas das quais o analisador pode não conseguir recuperar.</p> <p>O código 23 poderá resultar de um contacto insuficiente entre os pinos do analisador e o chip do cartucho. Nalguns casos, esta situação poderá ser corrigida através do condicionamento dos pinos no analisador, utilizando cartuchos cerâmicos de limpeza. O procedimento de condicionamento específico está descrito no final deste boletim.</p> <p>O código 70 pode ocorrer no Analisador Clínico Portátil se o utilizador premir a tecla DIS antes da execução do Simulador Electrónico após uma actualização de software. Neste caso, é necessário voltar a colocar as baterias para reiniciar o analisador e, em seguida, executar o Simulador Electrónico.</p> <p>Os códigos 82 e 92 indicam, geralmente, um problema nos transdutores de pressão no analisador. Se estes códigos persistirem, contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.</p> <p>O código 56 ocorre quando o analisador detecta ruído no circuito térmico. O ruído pode resultar de interferência electrónica. Se ocorrer este código, o analisador deve ser movido para um local diferente, afastando-o de potenciais fontes de interferências. Se o código continuar a ser apresentado no novo local, o analisador deve ser devolvido.</p> <p>Para outros códigos, executar duas vezes o Simulador Electrónico e, em seguida, executar um cartucho com uma amostra. Se o analisador passar na verificação do simulador e se não ocorrer uma verificação de qualidade com a execução da amostra, continuar a usar o analisador. Se o analisador não passar na verificação do simulador e/ou se ocorrer uma verificação de qualidade com a execução da amostra, contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.</p>


Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
69	Tipo de cartucho não reconhecido / Utilizar outro cartucho	<p>Este código pode ser devido à utilização de um tipo de cartucho que não é compatível com a versão do software no analisador ou à utilização de cartuchos fora do prazo. Verificar o prazo de validade dos cartuchos indicado na caixa ou bolsas dos cartuchos. Se os cartuchos estiverem dentro do prazo de validade e se estiver a ser executado um tipo de cartucho novo, contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para obter uma actualização do software.</p> <p>Ao analisar cartuchos de coagulação, o código 69 poderá ser causado por uma falha de contacto entre os pinos do analisador e o chip do cartucho. Nalguns casos, esta situação poderá ser corrigida através do condicionamento dos pinos no analisador, utilizando cartuchos cerâmicos de limpeza. O procedimento de condicionamento específico está descrito no final deste boletim.</p> <p>Durante a execução de cartuchos de imunoensaio, este código será apresentado se forem introduzidas informações incorrectas em resposta à instrução "Ler com scanner ou introduzir o número de lote do cartucho".</p> <p>O instrumento aguarda a leitura do código de barras localizado na parte de trás da embalagem unitária do cartucho individual. O código de barras correcto é parecido com a ilustração seguinte:</p>  <p>Relativamente aos cartuchos de imunoensaio, o instrumento não irá aceitar a introdução por teclado do número de lote do cartucho nem a leitura com o "scanner" do código de barras localizado na caixa dos cartuchos.</p> <p>Esta situação poderá dever-se a um cartucho anormal. No entanto, se a situação ocorrer repetidamente num analisador, este poderá necessitar de reparação. Contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.</p>

Os códigos 100 a 111 indicam uma situação de erro na tira de análise de glicose PCx e PCx Plus no i-STAT 1 Analyzer

Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
100	Erro na tira / Utilizar outra tira	O utilizador tentou executar uma tira molhada. Retirar a tira de análise. Premir 1 para Opções de Teste. Premir 1 para Mesmo Paciente ou Nível. Repetir a análise.
101	Erro na tira / Utilizar outra tira	A tira de análise foi retirada da porta para tiras durante a análise. Premir 1 para Opções de Teste. Premir 1 para Mesmo Paciente ou Nível. Repetir a análise.
103, 105, 106, 107, 111	Erro na tira / Utilizar outra tira	Teste falhado. Foi detectado um erro durante a sequência de análise. Retirar a tira de análise. Premir 1 para Opções de Teste. Premir 1 para Mesmo Paciente ou Nível. Repetir a análise. Se o problema persistir, registar o código de erro de três dígitos e contactar os serviços de assistência da Abbott Diabetes Care ou o representante de assistência técnica local.
102, 104	Erro na tira / Utilizar outra tira	A tira de análise não funcionou devidamente ou o nível de glicose no sangue na amostra está para além da capacidade de medição da tira de análise e do leitor de tiras. Retirar a tira de análise. Premir 1 para Opções de Teste. Premir 1 para Mesmo Paciente ou Nível. Repetir a análise com uma nova tira de análise. Se o erro voltar a acontecer, confirmar o resultado, realizando a análise por outro meio. Contactar os serviços de assistência da Abbott Diabetes Care ou o representante de assistência técnica local.
108, 109	Temperatura fora dos limites / Verificar página de estado	Durante a análise, a temperatura ambiente tornou-se instável ou ultrapassou os limites entre os quais o leitor de tiras de análise pode realizar uma análise. Certificar-se que a temperatura ambiente se encontra dentro dos limites especificados. Deixar que o analisador estabilize à temperatura ambiente de 15-40°C. Premir a tecla Menu até que seja exibido o Menu de Gestão. Premir 1 para Estado do Analisador onde a leitura da temperatura ambiente é exibida. Se a leitura da temperatura na Página de Estado se situar dentro dos limites descritos anteriormente, mas mesmo assim estes códigos persistirem, poderá haver problemas com um dos termistores no analisador. Contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.
110	Erro na tira / Utilizar outra tira	No início do ciclo de tiras de análise, o analisador avisa o operador para aplicar sangue na tira e aguarda 20 minutos até que o utilizador realize este procedimento. Este erro ocorre nos casos em que depois de decorridos estes 20 minutos, o analisador não detectou quaisquer indícios de sangue. A causa mais provável deste erro é a ausência de interacção por parte do utilizador.

Os códigos no intervalo de 120 a 138 e 140 a 151 indicam a ocorrência de uma falha durante um ciclo de cartuchos de imunoensaios. Na maior parte dos casos, o cartucho está gasto e deve ser usado um novo cartucho. Apenas o i-STAT 1 Analyzer produz este tipo de códigos, uma vez que o Analisador Clínico Portátil não suporta estes ciclos de imunoensaios.

Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
120-122, 124, 125, 133, 144, 148	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Estes códigos indicam um problema no movimento do fluido de análise durante a execução de um cartucho. Experimentar outro cartucho.
123	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	O controlo de qualidade durante a execução de um cartucho não verificou a presença de reagentes de imunoensaio activos. Experimentar outro cartucho.
126	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Este código pode estar relacionado com uma ligação eléctrica deficiente entre o I-STAT 1 Analyzer e o cartucho. Nalguns casos, esta situação poderá ser corrigida através do condicionamento dos pinos no analisador, utilizando o cartucho de condicionamento cerâmico. O procedimento de condicionamento específico está descrito no final deste boletim. Os códigos 50 e 128 estão, por vezes, igualmente relacionados com a ligação eléctrica. Se forem observadas várias ocorrências destes 3 códigos (50, 126 e 128) num curto período de tempo, deve-se considerar a hipótese de devolver o analisador para se proceder à respectiva substituição.
127	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Foi detectado um sensor molhado antes do movimento inicial da amostra. Cartucho, possivelmente, demasiado cheio ou usado. Experimentar outro cartucho.
128, 131, 132, 134, 135 - 138	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Estes códigos estão, na maioria das vezes, relacionados com um enchimento deficiente de um cartucho de imunoensaio, a presença de bolhas na amostra ou com a introdução abrupta de um cartucho no analisador. Instruções para se obter um enchimento adequado: <ol style="list-style-type: none"> Eliminar (sempre) 1 gota do dispositivo de aplicação para remover quaisquer bolhas não visíveis. Suspender uma única gota, ligeiramente superior ao orifício alvo redondo. Aplicar uma gota (apenas) no orifício alvo redondo, permitindo ao cartucho recolher a amostra. Confirmar se o volume de amostra está alinhado com a parte superior do diagrama RED FILL LINE (linha de enchimento vermelha). Fechar a tampa deslizante da esquerda para a direita. Instruções relativamente à introdução do cartucho: <ol style="list-style-type: none"> Depois de se fechar o cartucho, deve-se agarrar na tampa do cartucho entre o dedo indicador e o polegar. Na tampa, encontra-se uma reentrância destinada ao polegar. Orientar, suavemente, o cartucho para dentro do analisador até se ouvir um estalido suave.
129, 142, 143	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	O analisador detectou fluido de análise misturado com a amostra. Experimentar outro cartucho.
130	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	O analisador detectou uma bolha de ar no segmento de amostra. Experimentar outro cartucho.
140	Lote fora de prazo	O analisador detectou um lote cartuchos fora do prazo. Verificar o prazo de validade e repetir a análise utilizando um lote de cartuchos dentro do prazo de validade.

Número do código	Mensagem sobre a causa/acção no visor	Explicação
141	Teste cancelado pelo operador	Este código será apresentado se o código de barras do cartucho não for lido com o "scanner" no espaço de 60 segundos após a introdução do cartucho. O código de barras que deve ser lido é o que está localizado na embalagem unitária do cartucho e não o que se encontra na caixa dos cartuchos. Na apresentação do código 69 na tabela anterior, está ilustrado um exemplo do código de barras da embalagem unitária.
145	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	<p>O analisador não detectou a chegada de fluidos aquando da aplicação da amostra inicial. Esta situação pode ser causada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fuga do cartucho, • cartucho mal fechado. Certificar-se que a tampa deslizante está completamente encaixada antes de introduzir o cartucho no analisador. • cartucho pouco cheio. Assim que uma única gota de sangue entra em contacto no orifício alvo, os cartuchos de imunoensaio serão automaticamente cheios, absorvendo a amostra a uma velocidade determinada. A tentativa de injectar a amostra no cartucho ou de adicionar uma maior quantidade de amostra no orifício alvo não irá resultar num enchimento mais rápido do cartucho. Aguardar até que a amostra atinja a marca de enchimento máximo, "fill to", e depois fechar o cartucho.
146	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	Cartucho demasiado cheio. Repetir a análise.
147	Erro no analisador / Consultar Manual	<p>De modo a executar um cartucho de imunoensaio, o analisador i-STAT 1 Analyzer deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possuir o símbolo  e • estar configurado para <ol style="list-style-type: none"> a) Código de barras do cartucho necessário, ou b) Informações do cartucho necessárias primeiro e número de lote do cartucho necessário. <p>Basta uma destas condições acima descritas não ser cumprida para o analisador apresentar este código.</p>
149, 150, 151	Erro no cartucho / Utilizar outro cartucho	<p>O analisador detectou um fluxo atípico de dados do analisador. Experimentar outro cartucho.</p> <p>No caso do BNP, se o código 150 for apresentado durante o processamento de uma amostra de sangue total, recomenda-se que a amostra seja centrifugada e o teste seja repetido com o plasma resultante.</p>

As seguintes situações estão relacionadas com o Simulador Electrónico

Código	Explicação	Como responder
Código numérico	Consultar a secção Mensagens Codificadas do Analisador.	Consultar a secção Mensagens Codificadas do Analisador.
L	Canal potenciométrico fora dos limites. Esta situação pode ocorrer, nos casos em que se verifica uma acumulação de humidade nos pinos de contacto dentro do analisador quando este está sujeito a alterações de temperatura.	Permitir que a temperatura do analisador se equilibre em relação ao novo ambiente durante 30 minutos e repetir a análise. Se o código voltar a ocorrer, devolver o analisador.
G	Canal amperométrico fora dos limites. Esta situação pode ocorrer se o simulador externo não estiver bem inserido.	Reinsere correctamente o simulador. Se o código voltar a ocorrer, devolver o analisador.
R, r	Leitura de resistência no canal condutométrico fora dos limites.	Devolver o analisador.
t	Falha na sonda térmica.	Devolver o analisador.
B	Canal potenciométrico fora dos limites.	Devolver o analisador.

NOTA: Sempre que ocorrerem códigos repetidos que não se consigam localizar ou corrigir aplicando a formação fornecida, contactar os Serviços de Assistência i-STAT ou o representante de assistência técnica local para mais informações.

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAR UM CARTUCHO DE CONDICIONAMENTO CERÂMICO (CCC) I-STAT PARA O CONDICIONAMENTO DOS PINOS DO ANALISADOR.

Número do passo	Explicação
1. Executar um Simulador Electrónico externo.	Se o analisador estiver configurado com o simulador electrónico interno activado, executar um simulador electrónico externo. A execução do simulador electrónico externo garante que o ciclo do simulador interno não será executado durante o ciclo de condicionamento dos pinos, o que poderia originar o encerramento prematuro do processo.
2. Executar o CCC duas vezes.	Iniciar o ciclo do CCC tal como se iniciaria um ciclo de simulador electrónico externo. O instrumento identificará o CCC como sendo um simulador electrónico externo e exibirá um código de falha de simulador (i.e. rRGL) quando o ciclo estiver concluído. Ignorar o código, uma vez que se trata de um comportamento previsto.
3. Actualizar o registo de utilização do CCC	O registo encontra-se na página 3 do Boletim Técnico, na secção "Instruções para restaurar analisadores que produzem *** para Hematócritos e Código de Verificação de Qualidade 23", que é enviado em conjunto com o CCC. A actualização do registo permite ao utilizador manter um controlo do número de ciclos de condicionamento de pinos efectuados com a actual fita cerâmica do CCC. Caso necessário, substituir ou rodar a fita cerâmica de forma a que o CCC fique preparado para uma utilização futura.
4. Voltar a colocar o analisador em serviço.	

MedCare Comércio de Produtos e Equip. M. Hosp. Eireli



ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 795
SARANDI
PORTO ALEGRE
CEP: 91130-470
Fone: (51) 3365-7769

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 000045196
Série: 1
Folha(s): 1/2

Chave de Acesso: 4321 0104 8185 2800 0123 5500 1000 0451 9610 0063 4830
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso: 143210012633593
2021-01-20T15:39:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0962909068

INS. EST. SUBST. TRIBUTARIO
260302066

CNPJ
04.818.528/0001-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS

CNPJ/CPF
33.789.850/0007-65

DATA EMISSÃO
20/01/2021

ENDEREÇO
R WILSON BORDIN, 48

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
91665-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CAPINZAL

FONE/FAX
(49) 3555-1111

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

FATURA		TÍTULO		VENCIMENTO		VALOR	
001	Vencimento	25/01/2021	83.167,90				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
63.167,90	3.452,32	0,00	0,00	63.167,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESECONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				63.167,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0003-50
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 104	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962488542		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA ABBOTT	NUMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 2,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ	
														ICMS	IPI
04P75-01	I-STAT 1 ANALYSER - ANALISADOR Lote: 410795 (1) V. Indeterminada Trib aprox R\$: 4.042,06 Fed. 5.015,00 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 5DCCAC	90279099	100	6106	UN	1	41.800,0000	41.800,00	0,00	41.800,00	1.672,00	0,00	0,00	4%	0%
04P74-04	I-STAT 1 KIT DE IMPRESSORA Lote: 900684 (1) V. Indeterminada Trib aprox R\$: 437,10 Fed. 475,40 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 5DCC0AE	90279099	100	6109	JN	1	3.970,0000	3.970,00	0,00	3.970,00	158,80	0,00	0,00	4%	0%
06F11-01	I-STAT SIMULADOR ELETRONICO Lote: S-120745 (1) V. Indeterminada Trib aprox R\$: 335,81 Fed. 356,00 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 5DCC0AE	90279099	100	6108	UN	1	3.050,0000	3.050,00	0,00	3.050,00	122,00	0,00	0,00	4%	0%
04P73-04	I-STAT DOWNLOADER RECHARGER DRC-302 Lote: DRC-111765 (1) V. Indeterminada Trib aprox R\$: 547,91 Fed. 1.186,90 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 5DCC0AE	90279099	000	6108	UN	1	9.890,0000	9.890,00	0,00	9.890,00	1.146,80	0,00	0,00	12%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED: 28760
ESTE DOCUMENTO ESTARÁ QUITADO APÓS VLX. CRED. EM NOSSA C/C: 16.747-9 AO: 3745-2 BANCO: 001-DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
CONTRATO Nº 107/2020 SES 70396/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19.
Valores do ICMS em Oper. Inter. Convênio 93/2013: ICMS UF Dest. R\$: 7.206,22

RESERVADO AO FISCO



**MEDCARE COMERCIO DE PROD
E EQUIP. M. HOSP. EIRELI**

ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 709

SARANDI
PORTO ALEGRE
CEP: 91130-470
Fone: (51) 3365-7769

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
No: 000045196
Série: 1
Folha(s): **2/2**



Chave de Acesso:
432101048185280012355001000045196100634830
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso:
143210012633593
2021-01-20T15:39:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0962909066

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
260302066

CNPJ
04.818.528/0001-23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQ.	
														ICMS	IPI
CGF23-56	I-STAT 1.3V NIMH BATTERY - BATERIA RECARREGÁVEL DE HIDRETO METÁLICO DE NIQUEL Lote: B002018-05 (1) V: Indeterminada Trib aprox R\$ 132,56 Fed, 201,60 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br R\$ 5000AE	85079090	000	6108	UN	1	1.680,0000	1.680,00	0,00	1.680,00	201,80	0,00	0,00	12%	0%
CG4+	I-STAT CARTUCHO CG4+ C/25 CARTUCHOS Lote: M20283 (1) V: 08/06/21 Trib aprox R\$ 81,25 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br R\$ 5000AE	38220090	100	8108	CX	1	987,9000	987,90	0,00	987,90	39,52	0,00	0,00	4%	0%
CTNI	I-STAT CARTUCHO TROPONINA CTNI C/25 CARTUCHOS Lote: P202030 (1) V: 19/02/21 Trib aprox R\$ 110,56 Fed, Fonte: IBPT/empresometro.com.br R\$ 5000AE	38220090	100	8108	CX	1	1.790,0000	1.790,00	0,00	1.790,00	71,60	0,00	0,00	4%	0%



Transferências entre contas correntes BB

G334221459736720008

22/01/2021 15:04:31

Debitado

Nome CONGREGACAO M REPARADORAS
Agência 644-0
Conta corrente 52780-7

Creditado

Nome MEDCARE PROD EQUIP H LTDA
Agência 5745-2
Conta corrente 16747-9
Valor 63.167,90
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8018945 ADELAIDE FRIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES**

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento
Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

**PESQUISA DE PREÇOS Nº 3/2021.
PARA COMPRA DIRETA**

A CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS, HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC, informa que está promovendo **pesquisa de preços para compra direta.**

Essa pesquisa NÃO é destinada a formar preço para futura licitação, é para comprar do fornecedor que apresentar menores valores para o contido no anexo I.

Os recursos para a aquisição do objeto da presente pesquisa de preços são provenientes do **Contrato nº 107/2020 – SES 70386/2020** – Secretaria de Estado da Saúde destinados ao combate da pandemia da COVID-19.

APRESENTAÇÃO DE PREÇOS PELO VALOR GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	<p>ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS</p> <p>Descritivo: Analisador de Sangue portátil (Point of Care) para determinação quantitativa simultânea de elementos sanguíneos específicos, para pacientes críticos ou não críticos, totalmente automatizado que dispõe de um vasto menu de testes indicadores de diagnóstico e tratamento relacionados com a gestão do estado da doença e as linhas de orientação clínica, utilizando apenas 100ul de amostra de sangue arterial ou venoso, o sistema fornece o resultado em questão de minutos, operado em punho, pesando aproximadamente 650gramas, medindo 7,68cm X 23,48cm X 7,24cm., com controle térmico, bateria interna de lítio e calibração eletrônica. Possui sistema de introdução de dados tipo scanner e teclado alfa-numérico, e memoriza automaticamente até 1000 registros de testes. Sua saída e transmissão de dados são feita através de infravermelho e suas funções podem ser controladas por software de gerenciamento. Utiliza como único e exclusivo reagente os cartuchos para Bioquímica/Eletrólitos/Lactato, Hematologia, Gasometria, Coagulação, Endocrinologia e Marcadores Cardíacos, sem necessidade de eletrodos seletivos ou troca de gás. A leitura dos resultados ocorre em até 2 minutos para Bioquímica, Eletrólitos, Lactato, Hematologia e Gasometria, 5 minutos para Coagulação e 10 minutos para Endocrinologia e Marcadores Cardíacos. Acompanha impressora portátil para emissão de laudos, simulador eletrônico para calibração, base downloader/Recharger e bateria recarregável.</p> <p>Inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impressora portátil com infravermelho com pilhas recarregáveis e bobina de rolo termossensível, compatível com I-STAT. • Downloader/Recharger para recarregar uma bateria recarregável no analisador. Se o analisador contiver uma bateria recarregável, a bateria começa a recarregar automaticamente logo que o analisador é colocado no Downloader/Recharger. <p>O Downloader/Recharger tem também um compartimento para recarregar uma bateria recarregável fora do analisador. • Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel.</p>	UN	1



CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Certificado de Filantropia - Processo nº 23000.053029/2016-65

CNPJ: 33.789.850/0007-65 Inscrição Estadual: Isento

Tel: (49) 3555-1111 E-mail: licitacoes@hnsdd.com.br

CARTUCHOS: CARTUCHO CG4 Cartucho para exame de gasometria com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar os seguintes exames em amostras de sangue total venoso/arterial: Lactato, pH, PCO—2, PO2, TCO2, HCO3, BE e SO2. Leitura e resultado em 2 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível

CARTUCHO cTnI Cartucho para dosagem quantitativa da Enzima Cardíaca Troponina-I (cTnI) com tecnologia de micro sensores, contendo solução calibradora interna, capaz de realizar o teste de troponina cardíaca I em amostras de sangue total ou plasma, que pode contribuir para o diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio. Leitura e resultado em 10 minutos, para ser utilizado com o analisador I-STAT compatível.

A proponente deverá efetuar o treinamento do pessoal que irá trabalhar com o aparelho.

Garantia mínima de 12 meses.

MARCA:

TODAS AS DIMENSÕES E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS SÃO APROXIMADAS.

ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Até dia 14 de janeiro de 2021, até as 9 horas.

Retirada do edital: www.hnsdd.com.br

Informações: licitacoes@hnsdd.com.br

Capinzal, 7 de janeiro de 2021.

Adelaide Frigo
ADELAIDE FRIGO
Diretora

MURAL PÚBLICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL

Publicado em: 07 / 01 / 2021.

Retirado em: 05 / 02 / 2021.

Nome: Gracieli Dambrós - CPF: 050.897.559-95 - Assinatura: *Gracieli Dambrós*